


pH /Conductividad

pH y/o Conductividad fuera del rango.

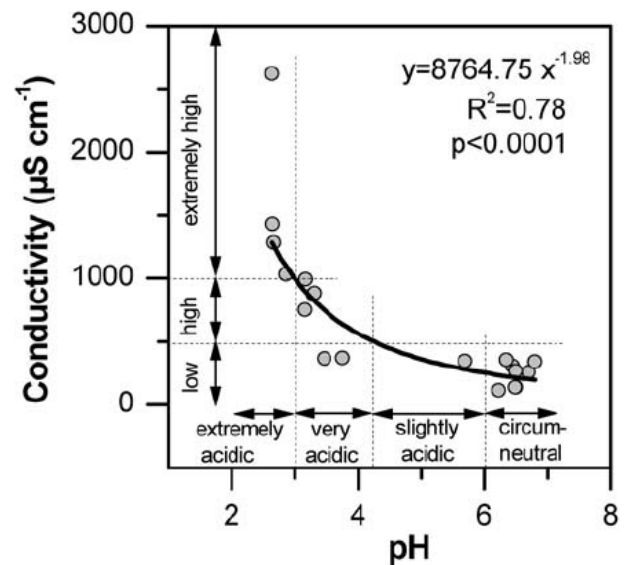

Causa	Recomendación
El agua entrante al sistema, varia en sus especificaciones.	Compruebe si su sistema de tratamiento de agua está produciendo a niveles estándar. Revise el agua del grifo para cualquier variación
Variación en la mezcla de solución de la fuente.	Contacte a su proveedor de soluciones de la fuente. Compruebe el dosificador para la exactitud y la consistencia.
Sistema de recirculación contaminada.	Reemplace si es necesario, limpie el sistema. Rellene con mezcla fresca.
Fórmula de tinta incorrecta	Consulte con su proveedor de tinta.
Base de pH del papel inconsistente o fuera de especificaciones.	Consulte con su proveedor de papel.
Alta población de hongos o bacterias	Consulte con su proveedor de solución de la fuente para determinar el tipo de contaminación. Siga las instrucciones para esterilizar el agua y el sistema de humectación.